

مـنشور عـ 52 / 2000

الموضوع : حول الإضطرابات الكهرومغناطيسية الناجمة عن استعمال الهواتف الخلوية الجواله.

المصحوب : أنموذج علامة منع.

إن الاستعمال غير المراقب للهواتف الخلوية الجواله من الصنف الرقمي و التماثلي المشغلة على التوالي طبقا لمقاييس جي أس أم 900 ميغاهرتز (GSM 900 MHZ) و مقاييس أن أم تي 450 ميغاهرتز (NMT450/MHZ) في المؤسسات الصحية و العيادات الطبية ، يدخل اضطرابات على التجهيزات الطبية التي تعمل بأنظمة الكترونية "قابلة أو غير قابلة للبرمجة " مثل مضخات التروية (pompes à perfusion) و تجهيزات الديال (dialyse) و فصادة الدم (hémaphèrese) و المنافيس (respirateurs) و أجهزة منطرة المرضى (monitoring des patients) و أجهزة البيولوجيا الطبية و أجهزة المصورات الطبية إلخ ...

علاوة على هذا فإن استعمال هذه الهواتف بالقرب من المنباهات القلبية المغروسة (stimulateurs cardiaques implantables)، يمكن أن يسبب اضطرابات قد تؤدي إلى الإخلال بالبرامج أو إدخال تغييرات عابرة على مستوى وظيفة المنباهات مما قد يولد تأثيرات خطيرة على صحة المرضى.

و للحد من تلك المخاطر فإنه يتعين ما يلي :

- اعلام الأعوان و المرضى و الزائرين بتلك لمخاطر و بكل ما يمكن أن ينجر عن استعمال هذه الهواتف.

و يمكن أن يتم هذا الإعلام عن طريق إشارات توضع في مدخل المؤسسة و بداخلها ، تنذر الأشخاص الحاملين لهاتف خلوي جوال بضرورة وضعه و المحافظة عليه في حالة توقف حتى لا يصدر و لا يتقبل الإشارات.


- اعلام حاملي المنباهات القلبية بخطر استعمال منباه قلبي و هاتف خلوي جوال في ذات الوقت عندما تكون المسافة بينهما أقل من 20 سنتيمتر.

- تنبيه حاملي المنباهات القلبية أيضا بعدم وضع هاتف خلوي جوال بالقرب من المنباه لتلافي الإخلال ببرمجته.

و إنني أولى أهمية قصوى لتطبيق ما ورد بهذا المنشور بكل دقة.

وزير الصحة العمومية

وزير الصحة العمومية

الإعضاء الدكتور  دي مهني

المرسل إليهم السادة :

- أعضاء الديوان
مديرو الإدارة المركزية


{ للإعلام

{ للإعلام و المتابعة

- المديرين الجهويين للصحة العمومية

{ للتنفيذ

- المديرين العامون للمؤسسات العمومية للصحة
- مديرو المستشفيات الجهوية و المحلية و المعاهد و المراكز المختصة
- المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية
- الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
- المديرية العامة للديوان القومي للأسرة و العمران البشري
- مديرو المصحات الخاصة
- أصحاب العيادات الطبية و المخابر الخاصة للتحاليل الطبية

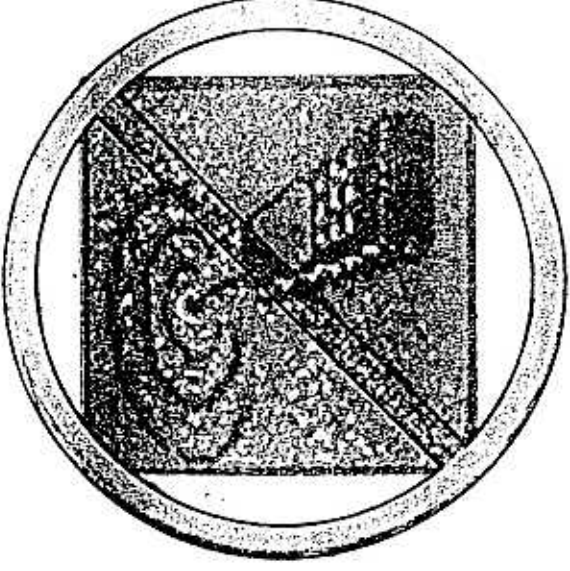

يمنع استعمال الهاتف الخليوي الجوال بهذا القسم
الرجاء وضع مفتاح تشغيل الجهاز في "موضع توقف"

نشكرا

L'utilisation du Téléphone Portable cellulaire est strictement interdite
dans ce service

Mettre l'appareil sur la «Position Arrêt»

MERCI